

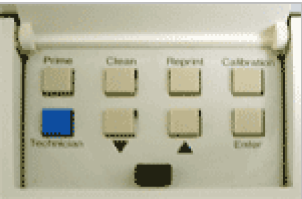





ABX Micros CRP	Changement des Produits
	<p style="text-align: center;"><b><u>Changement Alphalyse &amp; Miniclean</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ouvrez le compartiment frontal de l'appareil</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez les niveaux des produits</li> <li>▪ Remarques : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alphalyse placé avec étiquette en arrière afin de mieux observer le niveau</li> <li>○ Ligne bleu (top) - niveau de remplacement</li> <li>○ Ligne rouge (bas) - niveau tuyaux <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne pas dépasser afin d'éviter l'entrée de dépôt</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez 1x le bouton <b>Prime</b></li> <li>▪ Déchets : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Alphalyse</a> : vider dans les toilettes</li> <li>○ <a href="#">Miniclean</a> : vider dans les toilettes</li> </ul> </li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Changement Minidil</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À remplacer si le niveau marqué dans l'image par une ligne magenta est dépassé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez 2x le bouton <b>Prime</b></li> <li>▪ A chaque remplacement vérifiez le niveau de déchets</li> <li>▪ <a href="#">Déchets</a> : vider dans les toilettes</li> </ul>
<p> Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>	